


DIAMOND

Smart Lab Solutions

pH
Mg++
أبيرق

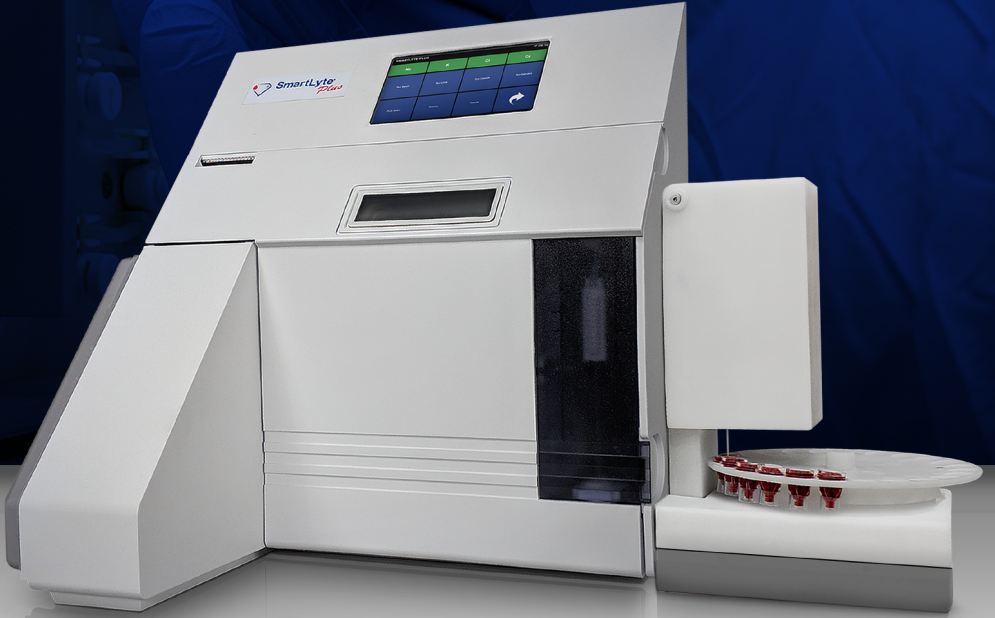

SmartLyte® Plus

محلل الالكتروليت الأكثر تقدماً

 smartlyteplus.com

SmartLyte[®] Plus



باراميتر	تراوح	¹ قابلية اعادة الانتاج	دقة الشاشة
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.5-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Na ⁺ لوب	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1- ازالة البلبا، معدل لقيم محد - عدم اداء لاجاد ي ج ذوم-ن-1
لوبل تا ثاني ع يف قدا ع موي ثل لال او موي ثل لال ال سا ي ق م ثي ال-2
ي فاضا في فاخت ب ل ط ي 3- (60-120)

راي تا ل
100-240V, 50W max
50-60 Hz, 1.6A max

ن زول او م ج ح ل
13.2 × 12.4 × 12 in , 14 lbs
335 × 315 × 295 mm, 6 kgs

ع طي ح م ل ف و ر ط ل
85% < ع ب و ط ر ل
60-90°F (15-32°C) : ف ر غ ل ا ق ر ا ح ع ج ر د

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746 U.S.A.
www.diamonddiagnostics.com
main@diamonddiagnostics.com
+1 508-429-0450